



Ліжко медичне у комплекті

OSD-B01P-D

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЕС

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Заходи безпеки	3
3.	Умови навколошнього середовища для експлуатації виробу, його експлуатаційні характеристики, технічні параметри, основні елементи конструкції	5
3.1.	Умови навколошнього середовища для експлуатації приладу	5
3.2.	Практичні характеристики виробу	5
3.3.	Основні елементи конструкції	5
4.	Запобіжні заходи, застереження та поради.....	6
5.	Технічні характеристики.....	8
6.	Інструкції зі встановлення та використання ліжка, аналіз несправностей та способи їх усунення	9
6.1.	Робота пульта керування	9
6.2.	Гальмування та розблокування коліщатка	10
6.3.	Встановлення узголів'я/задньої панелі	10
6.4.	Поручні	11
6.5.	Поверхня ліжка.....	12
6.6.	Запобіжник.....	12
6.7.	Аналіз несправностей обладнання та їх усунення	12
7.	Технічне обслуговування.....	13
8.	Транспортування та зберігання.....	15
9.	Список комплектувальних частин, цикли заміни та опис способу заміни тощо	15
9.1.	Перелік частин	16
9.2.	Список додаткових складових.....	16
10.	Належна утилізація продукту	16
11.	Відомості про сертифікацію	17
12.	Умови гарантії.....	18

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу. Збережіть її для отримання необхідної інформації у майбутньому.



УВАГА Не використовуйте медичне ліжко, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте медичне ліжко у випадку його пошкодження.

Не намагайтесь внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Медичне електричне ліжко «OSD-B01P-D» (далі за паспортом – функціональне ліжко / медичне ліжко / ліжко з електроприводом / ліжко / виріб) – це пристосування для інвалідів або людей похилого віку, які змушені тривалий час перебувати у постільному режимі.

Ліжко з електроприводом «OSD-B01P-D» рекомендоване для застосування у медичних закладах та вдома людям, позбавленим можливості пересуватися самостійно та користувачам, яким потрібен постійний нагляд медперсоналу.

Ліжко «OSD-B01P-D» розроблене для максимальної зручності та безпеки користувача.

2. Заходи безпеки

1. Перед початком використання ліжка або під час використання після тривалого зберігання

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що усі частини закріплені та міцно зафіковані.

2. Електричні ліжка повинні **ВИКОРИСТОВУватися** проінструктованими особами (персоналом).

3. До початку користування ліжком, асистент повинен **ПЕРЕКОНАТИСЯ** у тому, що ліжко не нанесе пацієнту ніякої шкоди.

4. Під час використання ліжка **СЛІДКУЙТЕ** за тим, щоб ніякі сторонні предмети, частини тіла чи одягу не потрапляли до механізму.

5. Ліжко **ПРАЦЮЄ** від мережі 220V.

6. **НЕ ПІДКЛЮЧАЙТЕ** ліжко до мережі з невідповідним вольтажем.

7. **ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ** виріб пацієнтами молодше 12 років (дітьми).

8. **ЗАБОРОНЕНО ПЕРЕМІЩАТИ** ліжко без попереднього відключення від мережі.

9. **НЕ МОЖНА** одночасно застосовувати декілька функції виробу.

10. **УНИКАЙТЕ** потрапляння рідин до електромотору.
11. Ремонт електричних частин виробу **ПОВИНЕН ПРОВОДИТИ** лише кваліфікований персонал із застосуванням оригінальних інструментів.
12. Електродвигун **ПРАЦЮЄ БЕЗПЕРЕБІЙНО** протягом 2 хвилин на разі відключення ліжка від електромережі, потім він **АВТОМАТИЧНО ВІДКЛЮЧИТЬСЯ** та **ВІДНОВИТЬ РОБОТУ** лише через 18 хвилин.
13. **НЕ СТВОРЮЙТЕ** перепони для роботи двигунів.
14. Користувачам, які тривалий час змушені перебувати у постільному режимі, **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** використовувати спеціальні протипролежневі матраци для профілактики та лікування пролежневих ран. Виробник ліжка **НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ** за виникнення у пацієнта пролежнів.
15. Регулярно **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан, адже усі елементи з часом зношуються.
16. Якщо виявлено несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
17. **БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
18. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескалаторах.
19. Максимальне навантаження на ліжко – 260 кг. **НИКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!



УВАГА
На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендуються систематично ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути перехресних інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування ліжка, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Умови навколошнього середовища для експлуатації виробу, його експлуатаційні характеристики, технічні параметри, основні елементи конструкції

3.1. Умови навколошнього середовища для експлуатації приладу

1. Температура навколошнього середовища: 10°C~40°C
2. Відносна вологість: 20 % ~ 80 %.
3. Атмосферний тиск: 760 гПа ~ 1060 гПа
4. Напруга джерела живлення: 220В зм. струму, 50Гц або 24 В пост. струму
5. Клас безпеки: Клас I, внутрішнє джерело живлення, деталь типу В, пристрій із захистом від бризок (IPX4)

3.2. Практичні характеристики виробу

Цей продукт створено для безпечної та зручного використання, підйом ліжка легко керується за допомогою пульта управління.

1. Плавність руху.
2. Ліміт навантаження.
3. Переміщення і блокування ліжка.
4. Рівень шуму < 65 дБ (A-зважування).
5. Функція подвійного відтягування пластини для спини та пластини ніг.
6. Електромагнітна сумісність відповідає вимогам стандарту YY 0505-2012.
7. Електрична безпека відповідає вимогам стандартів GB 9706. 1-2007 та YY 0571-2013.
8. За випробуваннями на вплив зовнішніх умов, виріб відповідає вимогам групи II GB/T 14710-2009, за механічними випробуваннями - групі II, Таблиця 6. За випробуваннями на вплив при перевезенні та випробуванням на адаптивність напруги джерела живлення, виріб відповідає положенням Глави 4 та Глави 5 GB/T 14710-2009 відповідно.

3.3. Основні елементи конструкції

Складається з узголів'я, рами ліжка, поверхні ліжка, приліжкової панелі, поручня, контролера, ручного управління, двигуна, основи, коліщаток. Як показано на рисунку нижче:



(1)	Живлення узголів'я ліжка	(2)	Кутова лінійка
(3)	Ручний контролер	(4)	Поверхня ліжка
(5)	Приліжкова рейка	(6)	Дошка для ніг ліжка
(7)	Каркас ліжка	(8)	Центральна педаль
(9)	Основа ліжка	(10)	Коліщатка 5"

УВАГА



Зображення є орієнтовними. Тому, можуть відрізнятися від оригінального продукту.

4. Запобіжні заходи, застереження та поради

Для кого призначений цей виріб

- Цей виріб призначений для використання виключно у дорослих пацієнтів під керівництвом медичного персоналу. Медичний персонал зобов'язаний проінструктувати пацієнта щодо способу використання виробу, враховуючи його симптоматику.
- Цей виріб не призначений для немовлят, маленьких дітей та людей, які не розуміють механізму його роботи.
- Цей виріб призначений для використання однією людиною. Не дозволяється використовувати виріб одночасно двома людьми. Коли медичному персоналу необхідно перебувати на ліжку одночасно з пацієнтом, спеціаліст має переконатися, що:
 - (1) Навантаження на ліжко не перевищує максимально безпечне навантаження: 260 кг.
(Примітка: Максимальне безпечне навантаження включає вагу матраца, вагу пацієнта, комплектувальних частин та безпечне навантаження, яке вони здатні витримувати.)
 - (2) Горизонтальне положення ліжка відрегульовано і воно опущене у найнижче положення; Коліщатка зафіковані так, щоб ліжко не рухалося.
 - (3) Безпечне робоче навантаження ліжка становить 1760 Н. Навантаження у 1760 Н

вважається сумаю наступного:

Пацієнтів	Рекомендована вага, (кг)	Рекомендована висота, (см)
Дитина	18-50	111-150
Дорослий	50-145	150-185

Потенційні загрози безпеці та обмеження щодо використання

1. Перед використанням приладу, уважно прочитайте цей Посібник з експлуатації. У разі використання виробу не у відповідності до інструкцій, викладених у цьому Посібнику, захист, забезпечуваний виробом, може бути порушенено.
2. Для нормальної роботи виробу, він має стояти на твердій поверхні, у добре вентильованому приміщенні з обмеженим впливом прямого яскравого світла.
3. Напруга в розетці має відповідати напрузі, на яку розрахований цей виріб (220 В змінного струму, 50 Гц), плюс заземлення (не ставте ліжко у положення, котре ускладнює його від'єднання від мережі живлення).
4. Якщо ліжко знаходиться без нагляду, основу слід розташувати в найнижчому положенні, щоб зменшити ризик травмування пацієнта у наслідок скочування з ліжка у положення лежачи або сидячи; Під час використання ліжка, коліщатка та ліжко мають бути надійно зафіковані, щоб запобігти ковзанню.
5. Коли електричне лікарняне ліжко не використовується або його потрібно перемістити, від'єднайте шнур живлення від розетки та намотайте його на механізм утримання; Не упускати шнур живлення на підлогу, щоб уникнути пошкоджень, спричинених коліщатками чи іншими предметами, які можуть його розчавити.
6. Якщо стан пацієнта (наприклад, втрата орієнтації через прийом ліків або клінічні умови) може привести до того, що пацієнт застрягне, каркас для матраца необхідно розташувати в рівному положенні (якщо за виключних обставин, від медичного персоналу на надійде інших інструкцій).

У разі нещасного випадку під час правильного використання виробу, необхідно вжити захисні заходи

для оператора та користувача, а також провести відповідні екстрені та коригувальні дії.

1. Ліжко має вимикач живлення, тому, якщо вам потрібно вимкнути живлення, будь ласка, вийміть вилку живлення або натисніть вимикач аварійної зупинки.
2. У разі надзвичайної ситуації, негайно натисніть «червоний» вимикач аварійної зупинки на ліжку, який може негайно припинити подачу електрики та контролювати робочий стан двигуна.

Вимоги до сумісного використання з іншим обладнанням

1. Цей виріб або система не повинні бути розташовані поруч з іншими пристроями або поєднуватися з ними, і якщо їх потрібно використовувати поблизу або разом, слід упевнитись, що вони можуть нормальню функціонувати у заданому положенні.

2. Коли ліжко підключено до зовнішньої мережі живлення:

- За звичайних умов і умов одиничної несправності, відкриті частини зовнішнього ланцюга живлення стають небезпечними.
- Або за звичайних умов і умов одиничної несправності, небезпечними стають відкриті частини обладнання.

Можлива несумісність з іншими пристроями під час використання та можливі ризики

Портативні та мобільні радіочастотні пристрої зв'язку можуть впливати на роботу електричних лікарняних ліжок. Під час використання рекомендується уникати сильних електромагнітних перешкод, наприклад, поблизу мікрохвильових печей.

Інші питання, про які слід нагадати оператору та користувачеві

За звичайних умов використання, у разі якщо ручне управління виходить з ладу, вам потрібно замінити ручний контролер, вийняти роз'єм з гнізда і знову встановити ручний контролер.

Якщо за звичайних умов використання пошкоджується запобіжник, ви можете скористатися запасним запобіжником, котрий іде у комплекті до ліжка.

5. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-B01P-D
Кількість секцій:	5
Привід:	електричний
Розмір, Д x Ш x В, (мм):	2160 x 1020 x 480-720
Регульована висота, (мм):	480-720
Кут підйому головної секції:	0-60°(±5)°
Кут підйому секції для ніг:	0-40°(±5)°
Функція «Тренделенбург» та «анти-Тренделенбург»:	так
Регулювання ліжка за висотою:	так
Поруччя:	так
Штатив під крапельницю:	так
Максимальне навантаження на ліжко, (кг):	260

6. Інструкції зі встановлення та використання ліжка, аналіз несправностей та способи їх усунення

Перед використанням, підключіть шнур живлення, увімкніть головний вимикач, і пристрій перейде в звичайний робочий стан.

6.1. Робота пульта керування



Керування ліжком здійснюється за допомогою пульта, який дозволяє легко відрегулювати кут нахилу головної та ножкої секцій. Пульт керування простий у використанні, фіксується на бічні поручні на комфортній для користувача відстані.

Після ввімкнення живлення, натисніть і утримуйте кнопку, щоб підняти або опустити ліжко, і відпустіть кнопку, щоб негайно припинити підйом.



Регулювання положення головної секції

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.



Регулювання положення ножкої секції

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.



Одночасне регулювання ножкої та головної секцій

Проводиться за допомогою лівої кнопки (одночасний підйом) та правої кнопки (одночасне опускання) на пульті управління.




Регулювання висоти ліжка над підлогою

Проводиться за допомогою лівої (підйом) та правої (спуск) кнопок на пульті регулювання.

6.2. Гальмування та розблокування коліщатка

Як показано на рисунку 2, гальмо натиснуто, а коліщатко перебуває в стані гальмування, щоб запобігти зісковзуванню ліжка. Якщо гальмо було опущене, підніміть його вгору, щоб вивільнити

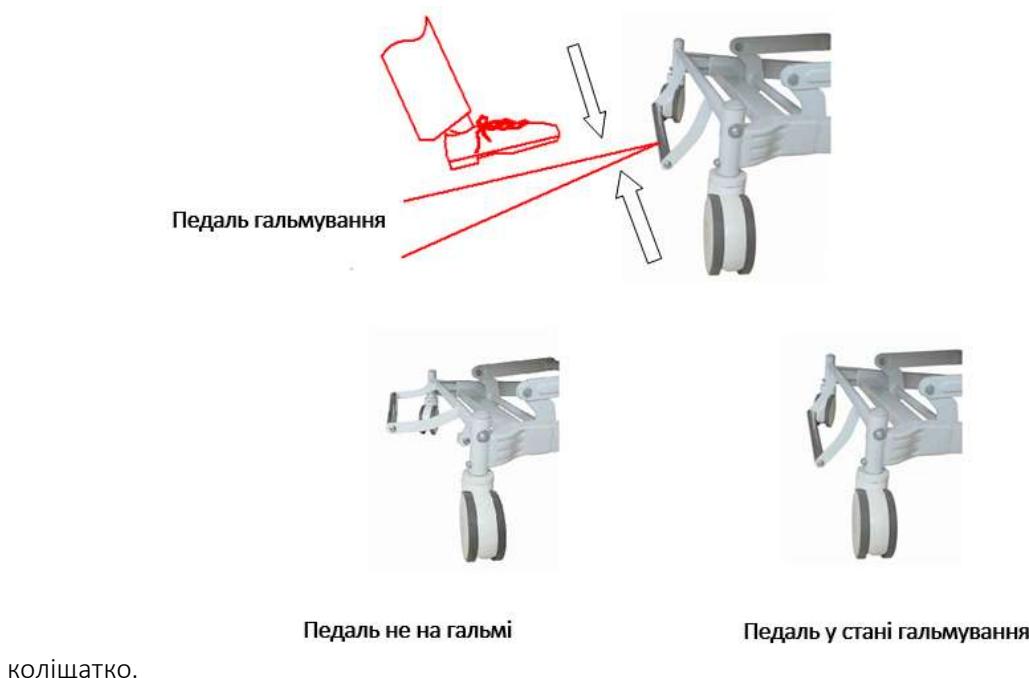

коліщатко.

Рис. 2

Примітка: Коли ліжко не рухається, коліщатка повинні бути в стані гальмування, щоб запобігти самовільному руху ліжка.

Якщо навантаження на ліжку більше за 260 Н, для його пересування по рівній поверхні необхідно 2 особи.

Увага!

- Під час переміщення ліжка переконайтесь, щоб навколо не було жодних перешкод. Якщо такі є, посуньте або приберіть їх. Не перетинайте перешкоди безпосередньо ліжком, щоб запобігти пошкодженню довколишніх предметів або деформації та пошкодженню ліжка.
- Окрім випадків переміщення ліжка, коліщатка повинні бути в стані гальмування, щоб запобігти його самовільному руху ліжка. Для пацієнтів небезпечно розхитувати ліжко при укладанні у ліжко або підйомі з нього.

6.3. Встановлення узголів'я/задньої панелі

Більшість компонентів цього виробу зібрано нашою компанією, а узголів'я/задня панель повинні бути встановлені замовником самостійно з міркувань транспортування.

Процес встановлення узголів'я/задньої панелі типу С:

- (1) Після відкривання коробки, вийміть узголів'я/задню панель.
- (2) Встановлення узголів'я ліжка та підніжжя виконується наступним чином:

Поверніть перемикач угору та вставте бортік або ніжку в тримач, як показано на малюнку нижче. Поверніть перемикач угору та вставте бортік або ніжку в тримач, як показано на Рис.3.

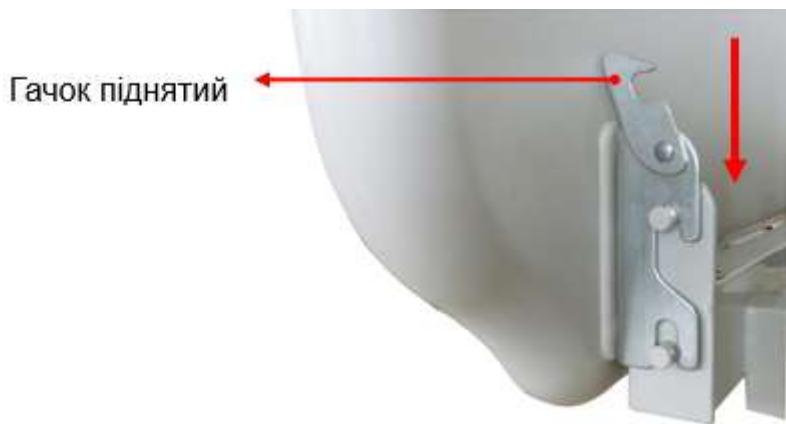


Рис. 3

- (3) Вставте узголів'я/задню панель (Рисунок 3) у відповідний металевий гачок, потім закріпіть узголів'я/задню панель за допомогою металевого гачка як показано на (Рисунку 4). Поверніть гачок вниз, щоб зафіксувати.

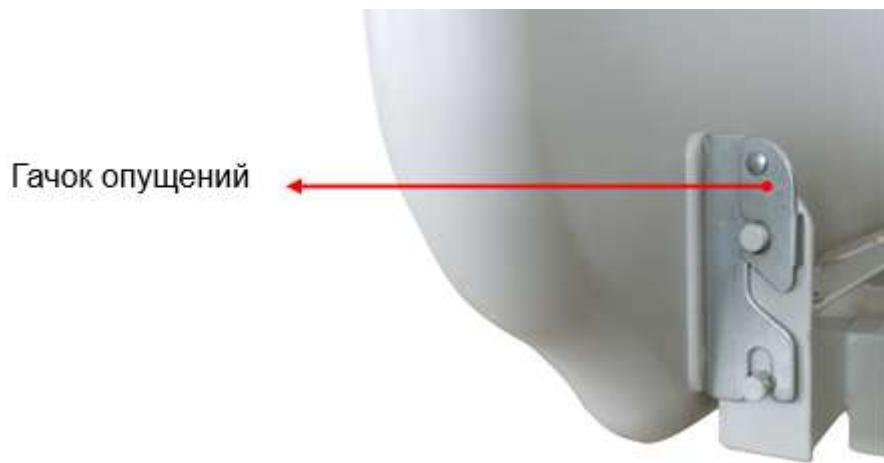


Рис. 4

6.4. Поручні

- (1) Піднімаючи або опускаючи поручень, слідкуйте за його рухом, щоб запобігти заклиниванню або травмуванню пацієнтів або оточуючих;
- (2) Категорично забороняється бити і дряпати гострими або твердими предметами по поверхні поручня;
- (3) Будь ласка, не використовуйте поручні, які не підходять. Використання

невідповідного поручня може спричинити механічне пошкодження конструкції.

6.5. Поверхня ліжка

Поверхня ліжка складається з п'яти секцій, усі вони виготовлені з високоякісної вуглецевої сталі Q235-A, точної машинної обробки.

- (4) Задня пластина: частина, яка виконує функцію опори для спини. За допомогою ручного управління, ви можете здійснювати підйом спини, кут підйому становить $\geq 60^\circ$.
- (5) Фіксована пластина: або секція для сидіння, використовується для підтримки сідниць пацієнта, тобто коли інші частини ліжка піднімаються, пацієнт сидить на цій пластині, вона закріплена на каркасі ліжка. Задня та стегнова пластини використовуються як поворотна точка опори.
- (6) Стегнова пластина: секція, яка використовується для підтримки положення стегон пацієнта. За допомогою ручного управління, ви можете регулювати положення стегнової пластини.
- (7) Литкова пластина: частина, яка використовується для підтримки литки та стопи пацієнта. Регулювання литкової пластини здійснюється опосередковано через регулювання положення стегнової пластини.

Увага!

- Категорично забороняється класти важкі предмети на край ліжка або сідати на нього при підйомі! Це може привести до деформації поверхні ліжка, що вплине на його нормальнє функціонування.
- Не бігайте, не стрибайте і не стійте на ліжку. Існує ризик випасти з ліжка і отримати травму.
- Категорично забороняється бити або дряпати поверхню ліжка гострими предметами та інструментами.
- При регулюванні підйому та опускання поверхні ліжка, категорично забороняється використовувати його у неправильній позі або напрямку. Це може привести до згинання суглоба в протилежну сторону, і як наслідок, до травмування або загострення наявної травми.

6.6. Запобіжник

Позначення FU1 та FU2 розташовані біля запобіжника. FU1 означає запобіжник пластини струму F2AL/250V (запобіжник електромережі), FU2 означає 5J Запобіжник (Запобіжник внутрішнього живлення) F2A250V.

6.7. Аналіз несправностей обладнання та їх усунення

1. Перед використанням ліжка перевірте наступне:

Місце несправності	Причина	Коригувальні дії
Ліжко нестабільне	Не розміщене на горизонтальній поверхні	Встановіть ліжко на рівну поверхню
При підніманні задньої частини узголів'я, воно нахиляється вперед	Штанга для підйому узголів'я не проходить через стопорне кільце	Будь ласка, пропустіть важіль підйому узголів'я через стопорне кільце
Ліжко нестійке і хитається вгору та вниз	Поверхня ліжка неправильно прикріплена до маленького кронштейна рами основи ліжка або не зафіксована	Правильно встановіть поверхню ліжка на маленький кронштейн рами основи ліжка та щільно зафіксуйте його.
Кнопковий перемикач активований, але ліжко не реагує.	Вилка джерела живлення не вставлена в розетку, незалежно від того, чи вимикач загального джерела живлення увімкнено.	Будь ласка, вставте вилку живлення в розетку, активуйте кнопку ручного управління за допомогою пульта. Коли загориться жовте світло, прилад увімкнено.
	Панель ручного управління не з'єднана з панеллю двигуна	Під'єднайте панель ручного управління до панелі двигуна
	Роз'єм контролера живлення двигуна погано підключений до роз'єму контролера живлення панелей управління спинкою і ножкою частиною ліжка	Під'єднайте контролер живлення двигуна до роз'єму контролера живлення панелей управління спинкою і ножкою частиною ліжка

2. Поширені способи усунення несправностей:

Несправність	Перевірка	Спосіб усунення
Кнопковий перемикач не реагує	Чи є електрика в розетці Чи вилка шнура живлення вставлена правильно Чи використовується безперервно протягом тривалого часу	Увімкніть інші прилади в розетку, щоб перевірити наявність струму Щільно вставте вилку в розетку Зачекайте 1 хвилину, перш ніж продовжити
Під час роботи чути шум	Перевірте, звідки іде шум і чи немає стороннього предмета	Якщо це рухома частина, нанесіть мастило Будь ласка, видаліть сторонні предмети

7. Технічне обслуговування

1. Методи очищення та технічного обслуговування лікарняних ліжок

- Уникайте тривалого перебування на сонці та під дощем.
- Не дряпайте поверхню ліжка твердим інструментами, гострими ножами тощо.
- Не піддавайте ліжко впливу високої температури та інтенсивного

інфрачервоного/ультрафіолетового випромінювання (85°C), оскільки це може призвести до поломки АСГ або розшарування пластику (червоний колір потьмяніє), тим самим скоротивши термін служби ліжка.

Лікарняне ліжко упаковується нетоксичними матеріалами, а бокс повинен мати ударостійкі та вологостійкі властивості.

- Щоб запобігти розмноженню бактерій або несправності обладнання та схем ,тощо, рекомендується, щоб спеціалісти регулярно очищали виріб слабколужним миючим засобом за допомогою чистої ганчірки та дезінфікували спиртом. Рекомендовано проводити дезінфекцію один раз на місяць.
 - Приводну частину навколо двигуна слід часто чистити віником і щіткою.
 - Будь ласка, додайте трохи мастила в обертову частину, щоб обертання було плавним і не було заїдання.
 - Під час чищення та технічного обслуговування лікарняного ліжка спочатку необхідну від'єднати його від мережі електроживлення.
 - Якщо на поверхню ліжка потрапила їдка рідина, швидко витріть її сухим рушником.
 - Періодичність технічного обслуговування — один раз на рік.
 - Поверхня, корпус, каркас ліжка, ніжки основи ліжка, двигун і поручні повинні перевірятися та профілактично обслуговуватися виключно фахівцями. Перевірте наявність заклиниування механізму, загрози безпеці пацієнта та випадкового ослаблення кріпильних елементів.
2. Акумуляторна батарея безпечна для використання та технічного обслуговування
- Безпечне використання: час першої зарядки батареї - чотири години. При відключенні живлення працює акумулятор.
 - При перевантаженні спрацьовує пристрій захисту від перевантаження, а акумулятор не працює.
 - Коли акумулятор розряджається, необхідно вчасно його зарядити.

Способи заміни акумулятора:

- a) Відкрийте верхню та середню кришки контролера, від'єднайте батарею на платі управління та вийміть акумулятор, який потрібно замінити;
- b) Зніміть жовту воскову втулку з точки зварювання акумулятора та приваріть усі з'єднувальні дроти вище;
- c) З'єднувальний дріт необхідно приєднати (припаяти) відповідно до кольору, червоний - до позитивного полюсу джерела живлення, чорний - негативного. Обов'язково зверніть увагу на жовту воскову оболонку на місці паяння;
- d) Вставте акумулятор, який було підключено, у місце для батареї контролера та вставте штекер у гніздо, що на платі. Зауважте, що акумулятор слід розташувати на відповідному боці, а електроди двох акумуляторів слід розташувати у шаховому порядку, щоб запобігти

пошкодженню, спричиненому контактом двох полюсів.

- e) Закрійте корпус контролера та закріпіть верхню і нижню частини корпуса за допомогою гвинтів.

Акумулятор має зберігатись у прохолодному, провітрюваному та сухому місці, не піддаватись впливу прямих сонячних променів, а поверхня батареї має завжди бути чистою.

- Якщо акумулятор потрібно залишити надовго, спершу повністю зарядіть його.
- Під час заряджання, акумулятор слід розміщувати в прохолодному та провітрюваному місці, а не в місцях з високою температурою та вологістю.
- Не використовуйте органічні розчинники для очищення корпусу акумулятора.
- Щоб уникнути небезпеки, не замикайте позитивний і негативний полюси акумулятора.
- Якщо акумуляторна батарея виходить з ладу, будь ласка, відправте її до авторизованого сервісу виробника або відповідних сервісних служб.
- Відпрацьовані акумулятори повинні накопичуватись та утилізуватися виробниками, їх не можна довільно викидати, щоб мінімізувати ризик забруднення навколишнього середовища.

Попередження: заміну батареї має виконувати фахівець, у іншому випадку, зверніться до сервісного центру виробника.

8. Транспортування та зберігання

1. При відправленні з виробництва, виріб упаковується відповідно до вимог водо-, волого- та ударостійкості. Правильно упаковане електричне лікарняне ліжко можна транспортувати звичайним транспортним засобом. Під час транспортування, його слід покласти та закріпити в коробці, щоб запобігти сильним ударам, вібрації, екструзії та потраплянню вологи. Користувачам суворо забороняється грубе поводження з вантажем під час транспортування, це допоможе уникнути пошкодження самого виробу або комплектувальних частин до нього.
2. Якщо обладнання не використовується протягом тривалого часу, воно має бути упаковане відповідно до вимог водо-, волого- та ударостійкості та зберігатися при температурі не вище $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, відносній вологості не більше 95 %, атмосферному тиску 76,0 кПа \sim 106,0 кПа. Приміщення має бути сухе та з гарною вентиляцією.

9. Список комплектувальних частин, цикли заміни та опис способу заміни тощо

Важливі складові (двигуни, контролери) і електричні схеми та інші технічні дані, що перелічені у цій інструкції, можуть бути надані всім агентам і користувачам обладнання за стандартною процедурою. У випадку несправності, ремонт має здійснюватися кваліфікованим фахівцем

сервісного центру.

Якщо за звичайних умов використання, запобіжник пошкоджується, виробник надає інший для його заміни.

За звичайних умов використання, у разі якщо ручне управління виходить з ладу, вам потрібно замінити ручний контролер, вийняти роз'єм з гнізда і знову встановити ручний контролер.

9.1. Перелік частин

Найменування	К-ть	Найменування	К-ть
Корпус ліжка (каркас, поверхня, основа)	1 шт.	Контролер	1 шт.
Узголів'я/задня панель	1 пара	Ручне управління	1 шт.
Поручень	2 шт.	Двигун	4 шт.
Коліщатка	4 шт.	Акумулятор	1 шт.
Амортизаційна вставка	4 шт.		

9.2. Список додаткових складових

Найменування	К-ть	Найменування	К-ть
Матрац	1 шт.	Штатив для крапельниці	1 шт.
Надліжкова трапеція	1 шт.		



10. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або у паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.

¹ Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.

² Медичне ліжко «OSD-B01P-D» відповідає технічним умовам і визнане придатним для експлуатації.

11. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-B01P-DR» відповідає технічним вимогам і визнано придатними для експлуатації.



Виробник: Zhongshan Aolike Medical Equipment Technology Co., Ltd. / Жонгшан Аоліке Медікал Еквіпмент Технолоджі Ко., Лтд. № 51, West Donghai Rd, Dongfeng Town, Zhongshan, Guangdong Province, 528425, P.R. China / № 51, Вест Донгхай Рд, Донгфенг Товн, Зхонгсхан, Гуандунг Провінсе, 528425 П.Р. Китай.



Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа». Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.

Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 4 від 24.12.2024.

Дата виготовлення: див. на маркованні.

Термін придатності виробу: див. на маркованні.

Гарантійний термін на **виріб «OSD-B01P-DR»** – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюються за рахунок клієнта.

12. Умови гарантії



ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (четирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу:_____

Підпис/Печатка:_____